

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «21» декабря 2023 г. № 2752

Регистрационный № 54418-13

Лист № 1  
Всего листов 7

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые WFK2; WFW2**

**Назначение средства измерений**

Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые WFK2; WFW2 (далее - счетчики) предназначены для измерений объема холодной питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 и воды в тепловых сетях по СанПиН 2.1.4.2496-09 систем теплоснабжения протекающей по трубопроводу в жилых домах, других промышленных зданиях при учетных операциях, а также в составе систем автоматизированного сбора, контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭР).

**Описание средства измерений**

Счетчик воды состоит из корпуса с камерой, в которую установлена крыльчатка с магнитом и счетного механизма.

Счетный механизм установлен на корпус и крепится к нему прозрачной защитной крышкой. Индикаторное устройство – 8 разрядов последовательных цифр, девятый разряд стрелочный.

Вращение крыльчатки через магнитную муфту передается на счетный механизм. Счетный механизм, имеющий масштабирующий механический редуктор, обеспечивает перевод числа оборотов крыльчатки в объем измеренной воды.

В счетчиках с удаленным считыванием сигнала на одном из колес редуктора установлен магнит, прохождение которого над герконом обеспечивает его замыкание.

При замыкании контактов геркона в цепи протекает ток, фиксируемый внешним счетчиком импульсов.

Электрическая цепь удаленного считывания сигнала выполнена в двух вариантах: первый – геркон включен в параллельно-последовательный резистивный делитель (цепь Намур), второй – чистые контакты геркона (цепь Геркон).

Для обеспечения работы счетчиков в составе систем беспроводного автоматизированного сбора, контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭР) в счетчиках вместо обычной стрелки долей использована стрелка долей в форме полукруга. Для оптического распознавания вращения стрелка долей изготовлена из оптически контрастного пластика, для магнитоиндукционного метода распознавания вращения стрелка долей изготовлена с металлическими вставками.

Внешний вид счетчиков представлен на рисунках 1-8.

Места пломбирования счетчиков приведены на рисунке 1.

Внешний вид исполнения счетчиков с защитой корпуса IP68 представлен на рисунке 2.

На счетчики со стрелкой, изготовленной с металлическими вставками, может устанавливаться электронный модуль в крышке-накладке, который обеспечивает распознавание направления вращения стрелки, подсчет числа оборотов за установленный период времени и передачу данных в систему АСКУЭР по проводным каналам: M-Bus, RS485

или по беспроводным каналам связи: радио 868,95 МГц, LoRaWAN, Nb-IOT и т.д. Внешний вид этих счетчиков изображен на рисунке 3.

Счетчики могут выпускаться с изображением на маркировочной пластине товарных знаков САНТЕХСЕТЬ, Danfoss (исполнение для горячей воды имеет обозначение Danfoss WMTW, исполнение для холодной воды имеет обозначение Danfoss WMTK), GIBAX и ДТРД. Внешний вид этих счетчиков изображен на рисунке 4 - 7.

Счетчики могут выпускаться в пластиковом корпусе, габаритные и присоединительные размеры которых полностью идентичны корпусу из латуни. Внешний вид этих счетчиков изображен на рисунке 8.

Счетчики соответствуют техническим требованиям ГОСТ Р 50193.1-92 при воздействии внешних магнитных полей, создаваемых подковообразным магнитом по МИ 2985-2006.

Счетчики выпускаются в следующих модификациях:

- 1) WFK20.xxxx, WFW20.xxxx - счетчики без удаленного считывания сигнала, степень защиты IP54 ГОСТ 14254-2015;
- 2) WFK23.xxxx, WFW23.xxxx - счетчики удаленного считывания сигнала Намур, степень защиты IP54;
- 3) WFK24.xxxx, WFW24.xxxx - счетчики удаленного считывания сигнала Геркон, степень защиты IP54;
- 4) WFK20.xxxx.IP68,  
WFW20.xxxx.IP68,  
WFK23.xxxx.IP68,  
WFW23.xxxx.IP68,  
WFK24.xxxx.IP68,  
WFW24.xxxx.IP68 - счетчики водозащищенные, степень защиты IP68;
- 5) WFK25.xxxx. WFW25.xxxx. - счетчики с установленным электронным модулем для дистанционной передачи данных;
- 6) WFK26.xxxx.,  
WFW26.xxxx. - счетчики с подготовкой для оптического или магнито-индуктивного способа считывания со стрелки долей, без электронного модуля;
- 7) WFK27.xxxx.,  
WFW27.xxxx. - счетчики с подготовкой для оптического или магнито-индуктивного способа считывания со стрелки долей без крышки и электронного модуля.

Запись обозначения исполнения счетчика образуется на основании условных обозначений:

WFX 2X.X XXX X X XX. IPXX, XXXX

OEM товарный знак на шильде при его наличии:  
Danfoss: WMTK хол. вода, WMTW гор. вода,  
САНТЕХСЕТЬ: ST, GIBAX: GB, ДТРД: DT.  
степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015,  
68 - водозащищенный; 54 – обычное исполнение.  
исполнения удаленного считывания:  
Проводной интерфейс Намур или Геркон:  
01 – 1 имп/литр; 10 – 1 импульс на 10 литров;  
RS – RS485; MB – модуль M-bus;  
Беспроводной интерфейс: LW1 – модуль LoraWAN  
исполнение 1; LW2 – модуль LoraWAN исполнение  
2; NB – Модуль NB-IoT;  
Комбинированный парный интерфейс в составе:  
TW1 – кабельный считыватель; TW2 – считыватель-  
передатчик.  
материал корпуса расходомерной камеры:  
P – полимерный, L – латунный.  
исполнение стрелки долей под считывание:  
1 - короткий для оптики 2 - длинный для оптики;  
3 - короткий с магнитом; 4 - высокий с магнитом.  
Установочная длина в мм:  
080 - 80 мм; 110 - 110 мм; 130 - 130 мм.  
Условный диаметр:  
D - 15 мм; E - 20 мм.  
модификация:  
20 - без удаленного считывания;  
23 - с удаленным считыванием (Намур);  
24 - с удаленным считыванием (Геркон);  
25 - с модулем передачи данных (LoraWAN; NB-IoT);  
26 - для оптического или магнитоиндуктивного  
считывания и крышкой для электронного модуля;  
27 - для оптического или магнитоиндуктивного  
способа считывания без крышки в комплекте.  
тип счетчика:  
WF - счетчик крыльчатый, K - для измерения  
холодной воды; W - для измерения горячей воды.



Рисунок 1 - Внешний вид и места пломбирования счетчиков

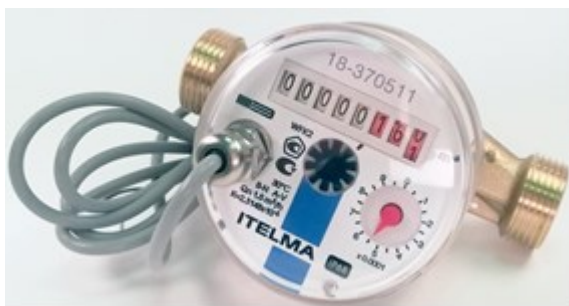


Рисунок 2 - Внешний вид счетчиков с защитой IP68



Рисунок 3 - Внешний вид счетчиков с модулем электронного считывания



Рисунок 4 - Внешний вид счетчиков с изображением товарного знака Danfoss



Рисунок 5 - Внешний вид счетчиков с изображением товарного знака САНТЕХСЕТЬ



Рисунок 6 - Внешний вид счетчиков с изображением товарного знака GIBAX

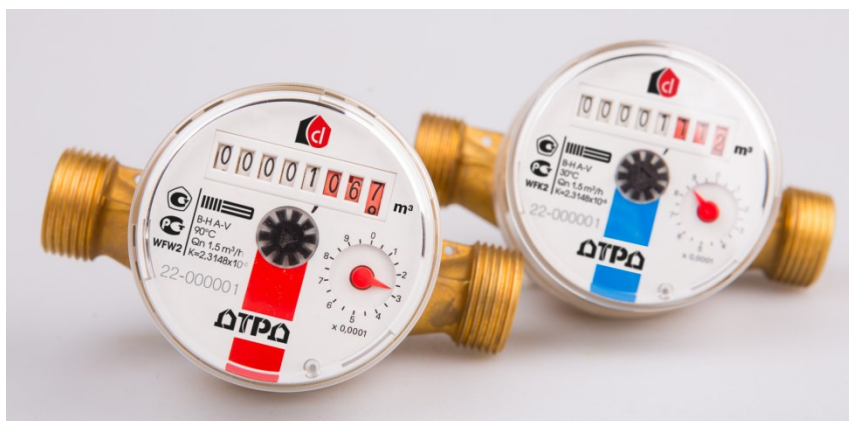


Рисунок 7 - Внешний вид счетчиков с изображением товарного знака ДТРД



Рисунок 8 - Внешний вид счетчиков в пластиковом корпусе

### Программное обеспечение

Программное обеспечение в метрологической части отсутствует.

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Обозначение счетчика	WFK2x.D080/110		WFK2x.E130	
	WFW2x.D080/110		WFW2x.E130	
Наименование характеристики	Значение			
Метрологический класс по ГОСТ Р 50193.1-92	B	A	B	A
Диаметр условного прохода $D_y$ , мм	15		20	
Максимальный расход, $q_{max}$ , м <sup>3</sup> /ч	3,0	3,0	5,0	5,0
Номинальный расход, $q_n$ , м <sup>3</sup> /ч	1,5	1,5	2,5	2,5
Переходный расход, $q_t$ , м <sup>3</sup> /ч	0,12	0,15	0,20	0,25
Минимальный расход $q_{min}$ , м <sup>3</sup> /ч	0,03	0,06	0,05	0,10
Порог чувствительности, м <sup>3</sup> /ч, не более	0,015	0,03	0,025	0,05
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %:				
в диапазоне расходов от $q_{min}$ до $q_t$	±5			
в диапазоне расходов от $q_t$ до $q_{max}$	±2			
Устойчивость к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха по ГОСТ Р 52931-2008	класс В4			
Устойчивость и прочность к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008	класс L2			

По метрологическим характеристикам счетчики относятся к классу В при горизонтальной установке, к классу А при вертикальной установке по ГОСТ Р 50193.1-92.

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение	
Температура рабочей среды, °С: для счетчиков холодной воды для счетчиков горячей воды	от +5 до +40 от +5 до +90	
Температура окружающего воздуха при относительной влажности 80 %, °С	от +5 до +60	
Номинальное рабочее давление, МПа	не более 1,6	
Потеря давления на максимальном расходе, МПа	не более 0,1	
Емкость счетного механизма, м <sup>3</sup>	99999	
Минимальная цена деления счетного механизма, м <sup>3</sup>	0,00005	
Потребляемый ток устройства считывания, мА, не более	100	
Присоединительные размеры, длина мм, резьба трубная, “	80/110; 3/4”	130; 1”
Масса счетчика, не более, кг	0,5/0,6	0,7
Средний срок службы, не менее, лет	12	

### Знак утверждения типа

наносится на шкалу счетного механизма методом тампопечати и на эксплуатационную документацию типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Счетчик	–	1
Защитный колпачок	–	2
Прокладка	–	2
Пломбирочная проволока	–	1
Паспорт	–	1

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе паспорта «4. Устройство и принцип действия».

### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ Р 50193.1-92 Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Технические требования;

ГОСТ Р 50193.3-92 Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Методы и средства испытаний;

ГОСТ Р 50601-93 Счетчики питьевой воды крыльчатые. Общие технические условия;

МИ 2985-2006 Счетчики холодной и горячей воды. Типовая методика испытаний на воздействие внешних магнитных полей;

ТУ 4213-001-817331698-2013 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые WFK2; WFW2 Технические условия.

**Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Научно- производственное предприятие «ИТЭЛМА Билдинг Системс» (ООО «НПП «ИБС»)

ИНН 7724869373

Юридический адрес: 115230, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ, ПРОЕЗД НАГАТИНСКИЙ 1-Й, Д. 10, СТР. 1, ОФ. 511

Телефон/факс: +7 (495) 933-38-97/+7 (495) 933-38-96

E-mail: [info@i-bs.ru](mailto:info@i-bs.ru)

Web-сайт: [www.i-bs.ru](http://www.i-bs.ru)

**Испытательный центр**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Тел./факс: +7 (495) 437-55-77/+7 437-56-66

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru), [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.