

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений  
№ 94324-25

Срок действия утверждения типа до 13 января 2030 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Счетчики тепла ЭКО НОМ СТУ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Общество с ограниченной ответственностью "Дюкс" (ООО "Дюкс"), г. Москва

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ  
Общество с ограниченной ответственностью "Дюкс" (ООО "Дюкс"), г. Москва

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
МП 1685-1-2024

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 6 лет

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 января 2025 г. N 39.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 525EEF525B83502D7A69D9FC03064C2A  
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович  
Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025

Е.Р.Лазаренко

«20» января 2025 г.

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «13» января 2025 г. № 39

Регистрационный № 94324-25

Лист № 1  
Всего листов 7

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**Счетчики тепла ЭКО НОМ СТУ**

**Назначение средства измерений**

Счетчики тепла ЭКО НОМ СТУ (далее – теплосчетчики) предназначены для измерений количества теплоты (энергии), объемного расхода жидкости и объема жидкости в потоке, интервалов времени, температуры жидкости (теплоносителя) в закрытых системах теплоснабжения и водоснабжения.

**Описание средства измерений**

Принцип работы теплосчётчиков состоит в измерении объёма жидкости в потоке и температуры жидкости в трубопроводе с помощью первичного преобразователя расхода (ультразвукового) и двух термопреобразователей сопротивления, входящих в состав теплосчетчика, и последующем вычислении полученной тепловой энергии, путем обработки результатов измерений вычислителем.

Теплосчетчики обеспечивают дистанционную передачу данных через интерфейсы (интерфейс указывается на вычислителе и в паспорте) типа импульсный выход, M-Bus, RS-485, LoraWan, NB-IoT и (или) через другие каналы беспроводной связи. Счетчики с интерфейсом RS-485, имеющие обозначение RS 485-4i оснащены 4-мя импульсными входами для вычисления объёма жидкости в потоке, полученного с приборов, оборудованных импульсными выходами и передачи измеренных данных в системы и комплексы автоматизированного сбора и передачи данных.

Теплосчетчики состоят из вычислителя, первичного преобразователя расхода и двух термопреобразователей сопротивления.

Вычислитель представляет собой микропроцессорное электронное устройство с жидкокристаллическим дисплеем и кнопкой управления. Вычислитель управляет процессом сбора измерительной информации от средств измерения параметров теплоносителя (жидкости), выполняет расчеты, хранит в энергонезависимой памяти необходимые для работы параметры, результаты измерений, часы работы и выводит их на дисплей. Энергонезависимая память хранит информацию часового архива за последние 60 суток, суточного архива за последние 6 месяцев, месячного архива (итоговые значения) за последние 36 месяцев.

Вычислитель имеет съемную конструкцию и может быть отсоединен от первичного преобразователя расхода и установлен в удобном для снятия показаний месте в пределах длины соединительных кабелей.

Первичный преобразователь расхода представляет собой измерительный участок с установленными ультразвуковыми датчиками, с помощью которых измеряется скорость движения жидкости в потоке и рассчитывается её объем на подающем или обратном трубопроводе.

Два термопреобразователя сопротивления измеряют температуру теплоносителя на подающем и обратном трубопроводе в системе теплоснабжения (водоснабжения).

Теплосчетчики имеют исполнения ЭКО НОМ СТУ-15.1, ЭКО НОМ СТУ-15.2, ЭКО НОМ СТУ-20, отличающиеся диапазоном расхода и номинальным диаметром.  
Общий вид теплосчетчиков приведен на рисунке 1.



а) вычислитель с термопреобразователями сопротивления



б) первичный преобразователь расхода

Рисунок 1 – Общий вид теплосчетчиков

Пломбировка теплосчетчиков осуществляется с помощью свинцовой (пластмассовой) пломбы, которой пломбируется корпус вычислителя, с нанесением знака поверки на пломбу.

Заводской номер теплосчетчиков наносится в цифровом формате на лицевую панель вычислителя любым методом, обеспечивающим несмываемую маркировку.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения знака поверки, знака утверждения типа и заводского номера представлены на рисунке 2.

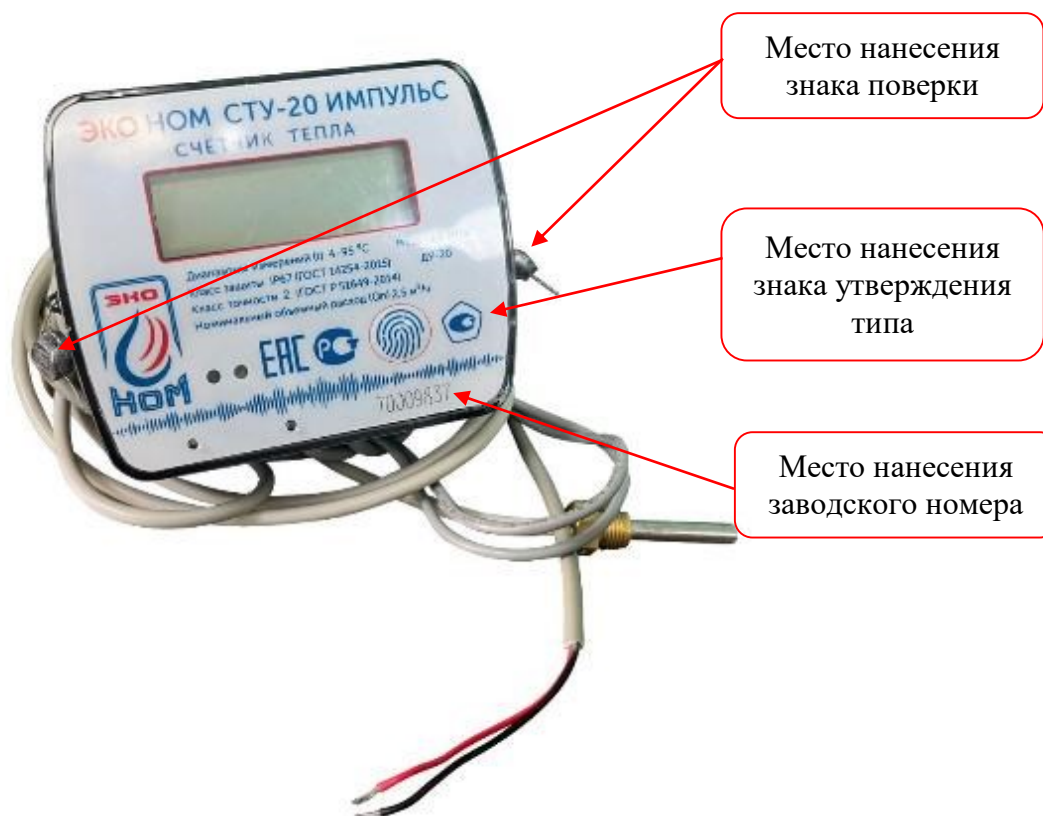


Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения знака поверки, знака утверждения типа и заводского номера

### Программное обеспечение

Программное обеспечение теплосчетчиков встроенное, устанавливается в вычислитель при изготовлении и не может изменяться в процессе эксплуатации.

Функции программного обеспечения: осуществление сбора и обработки поступающих данных от средств измерения параметров теплоносителя, выполнения математической обработки результатов измерений, вычисления, хранения результатов вычислений, измеряемых параметров, настроек, времени и архивирование данных.

Конструкция теплосчетчиков исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение теплосчетчиков и измерительную информацию

Метрологические характеристики средства измерений нормированы с учетом влияния программного обеспечения.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные программного обеспечения теплосчетчика приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	L_u
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 3.X <sup>1)</sup>
Цифровой идентификатор ПО	–
<sup>1)</sup> X – принимает значения от 0 до 9 и не относится к метрологически значимой части ПО	

## Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение		
	ЭКО НОМ СТУ-15.1	ЭКО НОМ СТУ-15.2	ЭКО НОМ СТУ-20
Исполнение			
Наименьший расход жидкости, м <sup>3</sup> /ч	0,012	0,03	0,05
Номинальный расход жидкости, м <sup>3</sup> /ч	0,6	1,5	2,5
Наибольший расход жидкости ( $G_{max}$ ), м <sup>3</sup> /ч	1,2	3,0	5,0
Порог чувствительности, м <sup>3</sup> /ч	0,010		
Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при измерении объема жидкости в потоке и объемного расхода жидкости, %	$\pm(2+0,02 \cdot G_{max}/G)$		
Диапазон измерений температуры жидкости (теплоносителя), °С	от +4 до +95		
Пределы допускаемой абсолютной погрешности теплосчетчика при измерении температуры жидкости (теплоносителя), °С	$\pm(0,6+0,004 \cdot  t )$		
Диапазон измерений разности температур жидкости (теплоносителя), °С	от +3 до +70		
Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при измерении разности температур жидкости (теплоносителя), %	$\pm(0,5+3 \cdot (\Delta t_{min}/\Delta t))$		
Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при измерении интервалов времени, %	$\pm 0,05$		
Пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя теплосчетчика при вычислении количества теплоты (энергии), %	$\pm(0,5+(\Delta t_{min}/\Delta t))$		
Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при измерении количества теплоты (энергии), %	$\pm(3+4 \Delta t_{min}/\Delta t +0,02 \cdot G_{max}/G)$		
$G$ – измеренное значение расхода жидкости, м <sup>3</sup> /ч; $G_{max}$ – наибольшее нормированное значение расхода жидкости, м <sup>3</sup> /ч; $\Delta t_{min}$ – наименьшее значение разности температур, °С; $\Delta t$ – измеренное значение разности температуры, °С; $t$ – измеренное значение температуры, °С.			

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение	
	ЭКО НОМ СТУ-15.1, ЭКО НОМ СТУ-15.2	ЭКО НОМ СТУ-20
Исполнение	ЭКО НОМ СТУ-15.1, ЭКО НОМ СТУ-15.2	ЭКО НОМ СТУ-20
Номинальный диаметр	DN15	DN20
Измеряемая среда	жидкость (вода)	
Потеря избыточного давления при $G_{max}$ , МПа, не более	0,025	
Избыточное давление измеряемой среды, МПа, не более	1,6	
Напряжение элемента питания постоянного тока, В	3,6 ±0,1	
Габаритные размеры, мм, не более:		
– высота	135	135
– ширина	80	85
– длина	110	130
Масса, кг, не более	0,85	0,95
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP 67	
Условия эксплуатации:		
– температура окружающей среды, °С	от +5 до +50	
– относительная влажность, %, не более	95	
– атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7	

Таблица 4 – Показатели надежности

Средний срок службы, лет	12
Средняя наработка на отказ, ч	55000

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель вычислителя методом, обеспечивающим несмываемую маркировку, и на титульный лист по центру вверху руководства по эксплуатации и/или паспорта типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Счетчик тепла	ЭКО НОМ СТУ	1 шт.
Руководство по эксплуатации	–	по заказу
Паспорт	–	1 экз.

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 1.1 РЭ 26.51.52-011-17666192-2023 Счетчики тепла ЭКО НОМ СТУ. Руководство по эксплуатации.

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений**

Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденная приказом Минстроя России от 17 марта 2014 г. № 99/пр (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2014 г., регистрационный № 34040);

ТУ 26.51.52-011-17666192-2023 «Счетчики тепла ЭКО НОМ СТУ. Технические условия».

### **Правообладатель**

Общество с ограниченной ответственностью «Дюкс» (ООО «Дюкс»)

ИНН 7710941397

Юридический адрес: 129344, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Бабушкинский, ул. Искры, д. 31, к. 1, оф. 43

Телефон: 8 (800) 333-87-99, +7 (495) 657-87-07

E-mail: info@eckonom.ru

Web-сайт: eckonom.ru

### **Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Дюкс» (ООО «Дюкс»)

ИНН 7710941397

Юридический адрес: 129344, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Бабушкинский, ул. Искры, д. 31, к. 1, оф. 43

Адрес места осуществления деятельности: 123290, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 2, стр. 2

Телефон: 8 (800) 333-87-99, +7 (495) 657-87-07

E-mail: info@eckonom.ru

Web-сайт: eckonom.ru

**Испытательный центр**

Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии – филиал  
Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский  
научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева» (ВНИИР –  
филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Фактический адрес: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская,  
д. 7 «а»


Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 19

Телефон: +7(843) 272-70-62, факс: +7(843) 272-00-32

E-mail: office@vniir.org

Web-сайт: www.vniir.org

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310592.

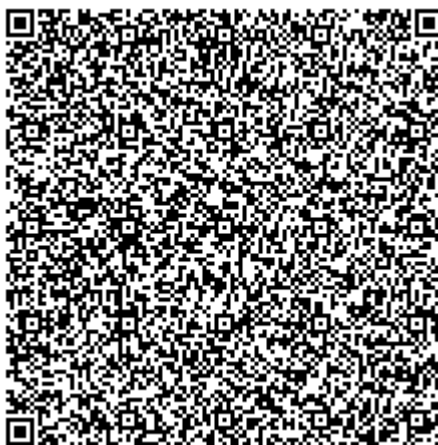

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 525EEF525B83502D7A69D9FC03064C2A  
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович  
Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025

Е.Р.Лазаренко

М.п

«20» января 2025 г.